# POMPA PERISTALTICA

# MP1 FAST – PH

Data Sheet

**DESCRIZIONE**

- ✓ **P**ompa peristaltica digitale con strumento di controllo **pH** integrato
- ✓ **A**datta a dosare **prodotti acidi**
- ✓ **P**rogrammazione del **set point** facilitata su un intervallo compreso **fra 6,0 e 8,0 pH**
- ✓ **C**alibrazione su un solo valore di 7,0 pH
- ✓ **V**isualizzazione istantanea del valore del pH su display
- ✓ **F**unzionamento **proporzionale** con tempi di ON/OFF di 150 secondi fino al raggiungimento del setpoint
- ✓ **A**llarme temporale di sovra-dosaggio o fine prodotto
- ✓ **R**ilevazione **stato di salute della sonda**
- ✓ **D**isplay digitale a segmenti
- ✓ **L**ed di allarme stato e dosaggio
- ✓ **A**limentazione standard **230 Vac** 50-60 Hz
- ✓ **I**nterruttore ON / OFF
- ✓ **C**assa in **PP rinforzato**
- ✓ **V**etrino in SAN
- ✓ **P**ortarullini in **PBT a 2 rullini**
- ✓ **P**rogrammazione facile e manutenzione minima
- ✓ **P**rotezione **IP 55**
- ✓ **I**n conformità con le normative **CE**

**OPTIONAL**

- ✓ **S**pina SCHUKO

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| | **Configurazione standard** |
| | |
| **C**assa | **Polipropilene caricato vetro** |
| **R**ullini | **DELRIN** |
| **T**ubo | **Santoprene** |
| **A**limentazione | **230 Vac 50 – 60 Hz** |
| **P**otenza assorbita | **12 Watt** |
| **P**eso | **1,6 kg** |
| **R**accordi | **Ghiere in PP per tubo 4 x 6 mm** |
| **A**ttacco sonda | **BNC** |
| **V**alvola iniezione / filtro fondo | **Valvola a labbro (PP + VT)** |
| **T**ubo aspirazione | **PVC 4 x 6** |
| **T**ubo mandata | **PE 4 x 6** |



Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

# POMPA PERISTALTICA

# MP1 FAST – PH

Data Sheet

| SPECIFICHE TECNICHE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Portata | | Pressione | | Materiale tubo | Misure tubo [mm] | RPM |
| | [l/h] | [cc/min] | [Bar] | [PSI] | | | |
| **1,6 – 01** | 1,6 | 26,66 | 1 | 14,5 | Santoprene | 4 x 7 | 30 |

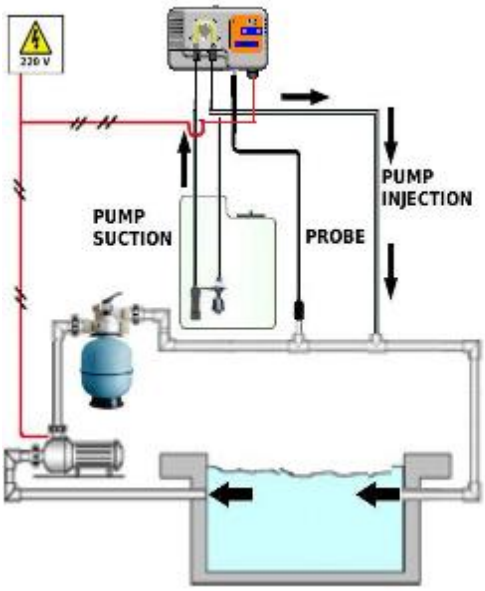


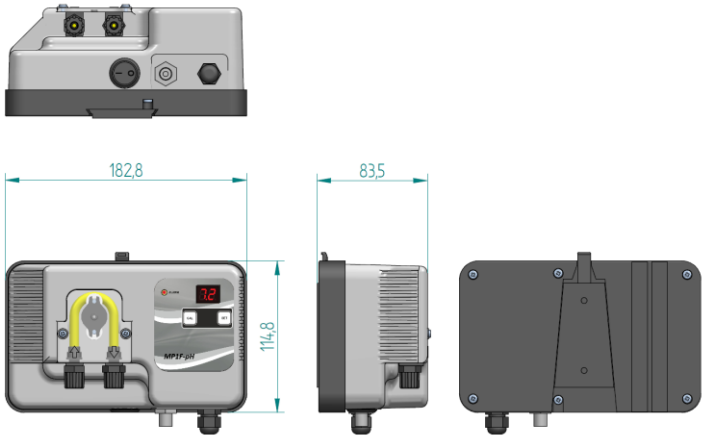


| KIT ACCESSORI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT STANDARD | | | | | KIT INSTALLAZIONE SU RICHIESTA | | | |
| *Nr. 1 Valvola Iniezione 1/2" PP-Valv. labbro-Viton®* | *Nr. 1 Filtro aspirazione 1/2" PP-Valv. labbro-Viton®* | *Nr. 1 Tubo Mandata 2mt PE 4x6* | *Nr. 1 Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6* | | *Nr. 1 Elettrodo di pH cavo 5 mt. Corpo epoxy* | *Nr. 1 Soluzioni tampone (pH 7)* | *Nr. 2 Collari di presa Φ50 att. 1/2"* | *Nr. 1 Porta sonda per tubazione 1/2" PP* |
| | | | | | | | | |



Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it